

Razionalizzazione dei percorsi d'acquisto di nuove tecnologie sanitarie: implementazione della modulistica aziendale in un'ottica di mini-HTA

Rognoni I, Andriulo E, Car A, Pisterna A.

Sc Farmacia Ospedaliera, Ospedale Maggiore della Carità, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italy

Obiettivo

Ottimizzare il percorso di richieste di nuovi DM alla CADM, implementando l'attuale modulistica al fine di estrapolare informazioni in modo rapido, per popolare le 4 dimensioni in ottica mini-HTA.

Introduzione

A seguito della continua innovazione tecnologica, la nostra azienda sanitaria si è trovata sempre più a dover fronteggiare, da un lato i crescenti bisogni assistenziali e dall'altro la sostenibilità economica. Per affrontare questa esigenza, nel 2019 è stato rivisto il regolamento della Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) insieme a procedure e modulistica. Principale limite dell'attuale modulo risulta essere un focus esclusivo sul Dispositivo Medico (DM) richiesto, e una carenza di informazioni relative alla descrizione dell'attuale pratica clinica e delle possibili alternative.


Materiali e Metodi

Sono stati esaminati i verbali CADM del 2020 e dei primi nove mesi del 2021 contenenti tutte le richieste pervenute e le motivazioni di domande eventualmente respinte; è stato creato un registro in Excel con le informazioni di interesse per la successiva analisi dei dati. È stata inoltre analizzata l'attuale modulistica aziendale per l'acquisizione di nuovi DM, per individuare quali potessero essere i campi da integrare o modificare al fine di estrapolare informazioni utili a popolare le 4 dimensioni (tecnologia, paziente, aspetti organizzativi, aspetti economici). Per la revisione si è fatto riferimento ai modelli di mini-HTA e Hospital Based HTA.


Risultati

Nell'anno 2020 sono state sottoposte alla CADM 36 richieste d'acquisto di nuovi dispositivi medici, mentre 29 sono state presentate nel 2021. Di queste, rispettivamente, il 50% e il 52% sono state sospese dalla CADM a causa di insufficiente documentazione a supporto della domanda.

Dall'analisi di ciascuna richiesta è emerso quanto segue: in riferimento all'analisi della tecnologia risultano carenti la descrizione degli standard attuali e le informazioni degli aspetti di efficacia e sicurezza; per gli aspetti organizzativi non ci sono campi relativi al regime assistenziale e alla eventuale necessità di formazione degli operatori; infine mancano i dati relativi alla tipologia di letteratura a supporto.

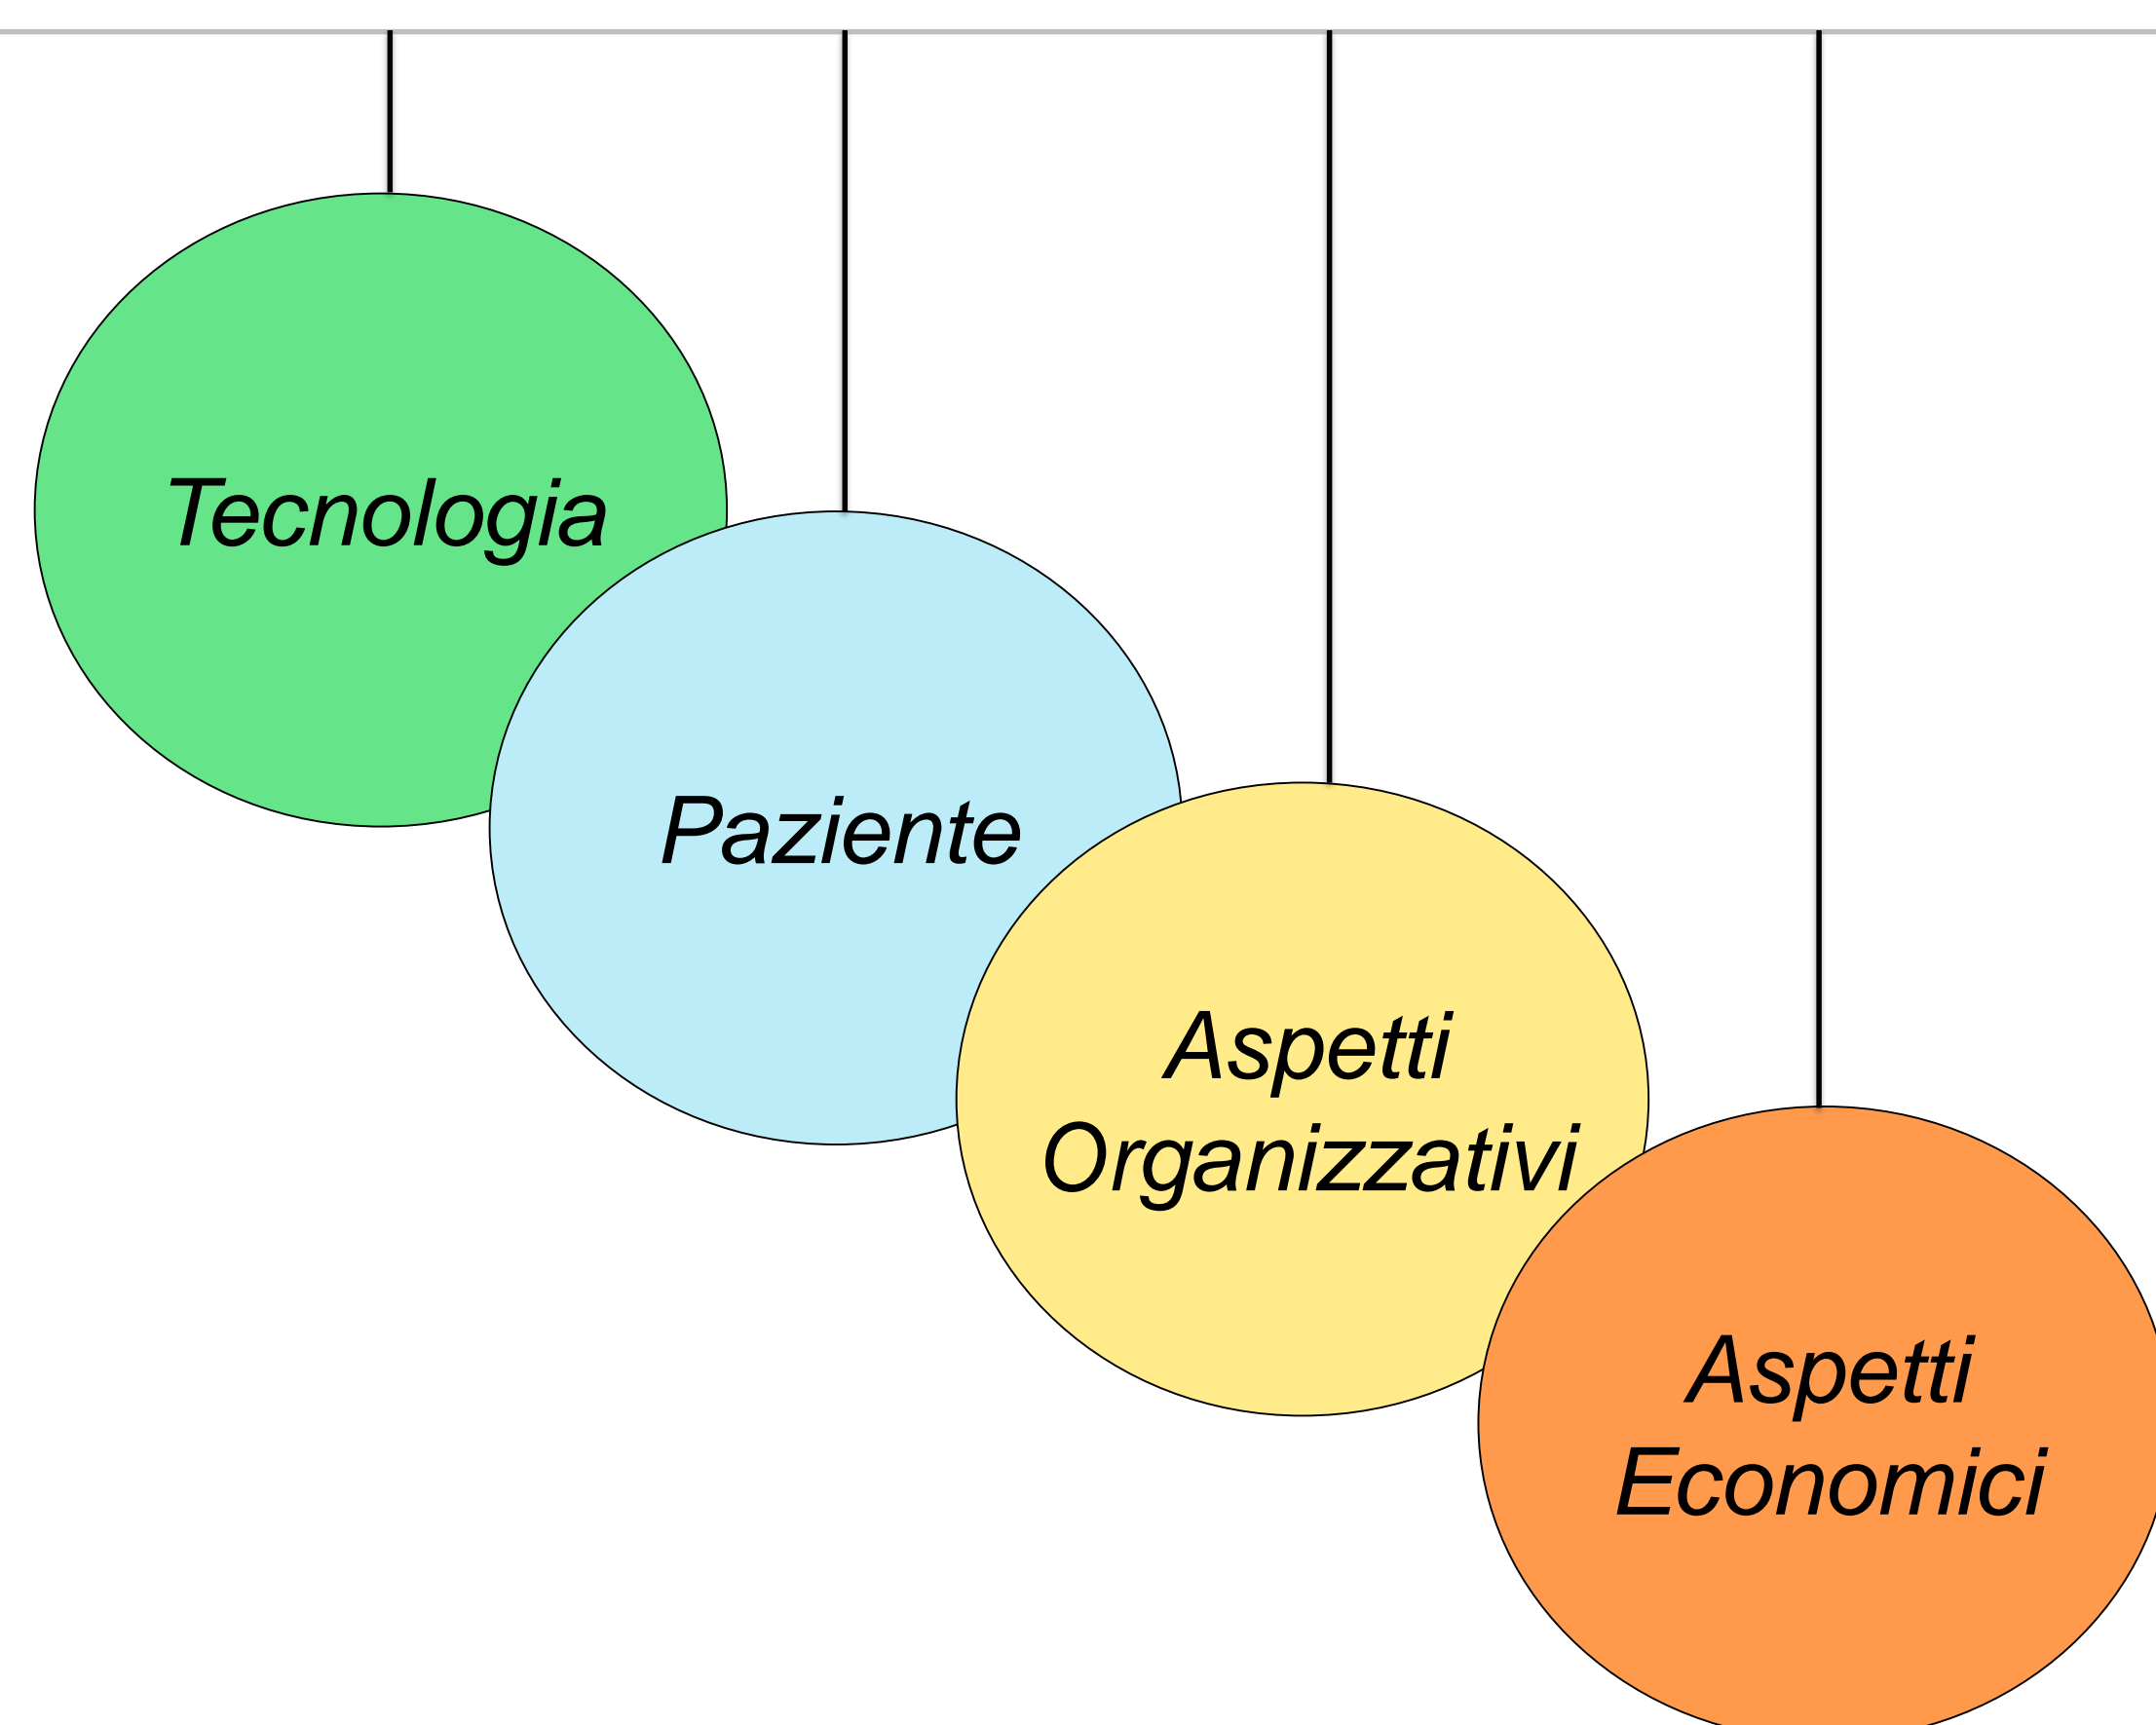


Richieste presentate alla CADM - 2020



Tipologia di DM richiesti

	2020	2021
strumento - apparecchiatura	18	17
sistema cardiovascolare	3	7
apparato respiratorio	4	1
medicazione	2	0
software - parametri non invasivi	2	1
impianti oftalmologia	0	1
varie	6	1
apparato gastrointestinale	1	0

Richieste presentate alla CADM - 2021



Discussione e Conclusioni

Sulla base di quanto emerso il modulo verrà strutturato con l'aggiunta di alcuni campi che vadano a sopperire alle carenze riscontrate. Nella prossima seduta della CADM verrà proposta come esperienza pilota la nuova modulistica, da utilizzarsi negli ultimi 2 mesi dell'anno, per renderla operativa dal 2022. Il farmacista ospedaliero, nell'ambito del gruppo multidisciplinare, ha evidenziato importanti criticità proponendo un percorso che consenta alla CADM di velocizzare l'emissione di pareri, ma soprattutto, di acquisire elementi utili al fine di avere una visione d'insieme su come i nuovi prodotti si collocano nei percorsi aziendali, perseguendo il continuo miglioramento della qualità e dell'accessibilità economica alle cure.