

## DISPOSITIVO-VIGILANZA: ANALISI DELLE SEGNALAZIONI DI INCIDENTE NEL BIENNIO 2018-2019 PRESSO L'OSPEDALE PEDIATRICO AOU MEYER

M. Asprea [1], L. Giovannetti [2], R. Caputo [2], L. Di Simone [1], M. Chiarotti [1], A.M. Calvani [1]

[1] SOSA Farmacia, AOU Meyer; [2] Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi di Firenze



### INTRODUZIONE


L'obiettivo del sistema di dispositivo-vigilanza (DV) è quello di salvaguardare la salute e la sicurezza dei pazienti, riducendo la possibilità che lo stesso tipo di incidente si ripeta in luoghi diversi in tempi successivi.

La normativa attinente al monitoraggio degli incidenti stabilisce che il responsabile di DV è tenuto a comunicare immediatamente al Ministero della Salute qualsiasi incidente, ovvero qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che possano causare o aver causato il decesso o il grave peggioramento della salute di pazienti o operatori. L'obiettivo di questo lavoro è l'analisi delle segnalazioni processate nel biennio 2018-2019 presso l'AOU Meyer.

### MATERIALI E METODI

Il farmacista responsabile, una volta a conoscenza della segnalazione di incidente, controlla la completezza delle informazioni riportate nella scheda cartacea dall'operatore che ha riscontrato l'evento e provvede all'inserimento online sul sito del Ministero della Salute. Successivamente trasmette la segnalazione via PEC allo stesso ed alla Ditta fornitrice/fabbricante. A partire dal 2018, il responsabile ha predisposto un registro elettronico delle segnalazioni verificandosi specificando se si tratta di incidente o mancato incidente, CND, REF, descrizione dell'evento, reparto coinvolto e numero di repertorio.

### SISTEMA DI DISPOSITIVO-VIGILANZA

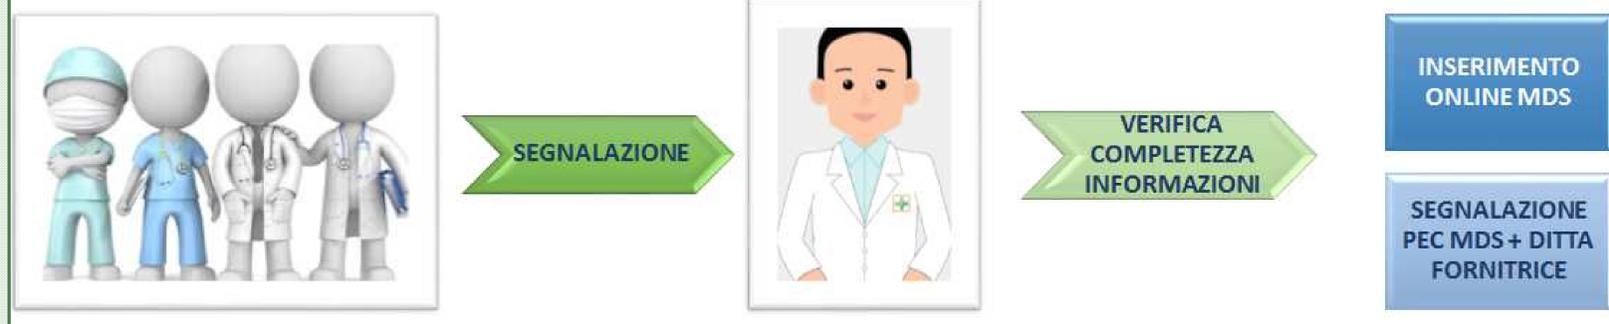


### RISULTATI

Nel biennio 2018-2019 sono state effettuate 26 segnalazioni di cui il 27% sono incidenti e il 73% sono mancati incidenti. Nel dettaglio, i DM maggiormente coinvolti sono: dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (categoria A della CND) che rappresentano il 42% delle segnalazioni, seguiti dai dispositivi per apparato urogenitale con una percentuale del 27%.

Analizzando i dati relativi alla qualifica del segnalatore è emerso che sia operatori sanitari (61,5%) che medici (38,5%) sono coinvolti e sensibilizzati alla segnalazione.

I reparti maggiormente attivi sono: la farmacia relativamente all'attività di nutrizione parenterale totale (27%), la chirurgia urologica pediatrica (23%) e la terapia intensiva neonatale (15%).

### ANALISI DELLE SEGNALAZIONI NEL BIENNIO 2018-2019

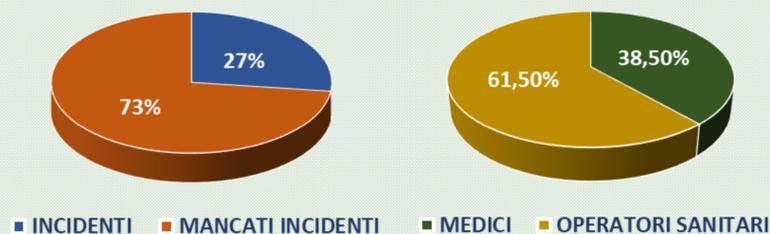

### DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Dall'analisi dei dati riportati si evince che l'ottima attività svolta dal farmacista responsabile di DV e la conseguente sensibilizzazione del personale sanitario sono risultati fondamentali per stimolare la segnalazione di possibili incidenti dovuti al DM. Tuttavia è altrettanto necessario lavorare per accrescere la formazione del personale sanitario affinché il sistema di DV risulti ancora più efficiente nel salvaguardare la sicurezza del paziente.